



# 異物検査装置

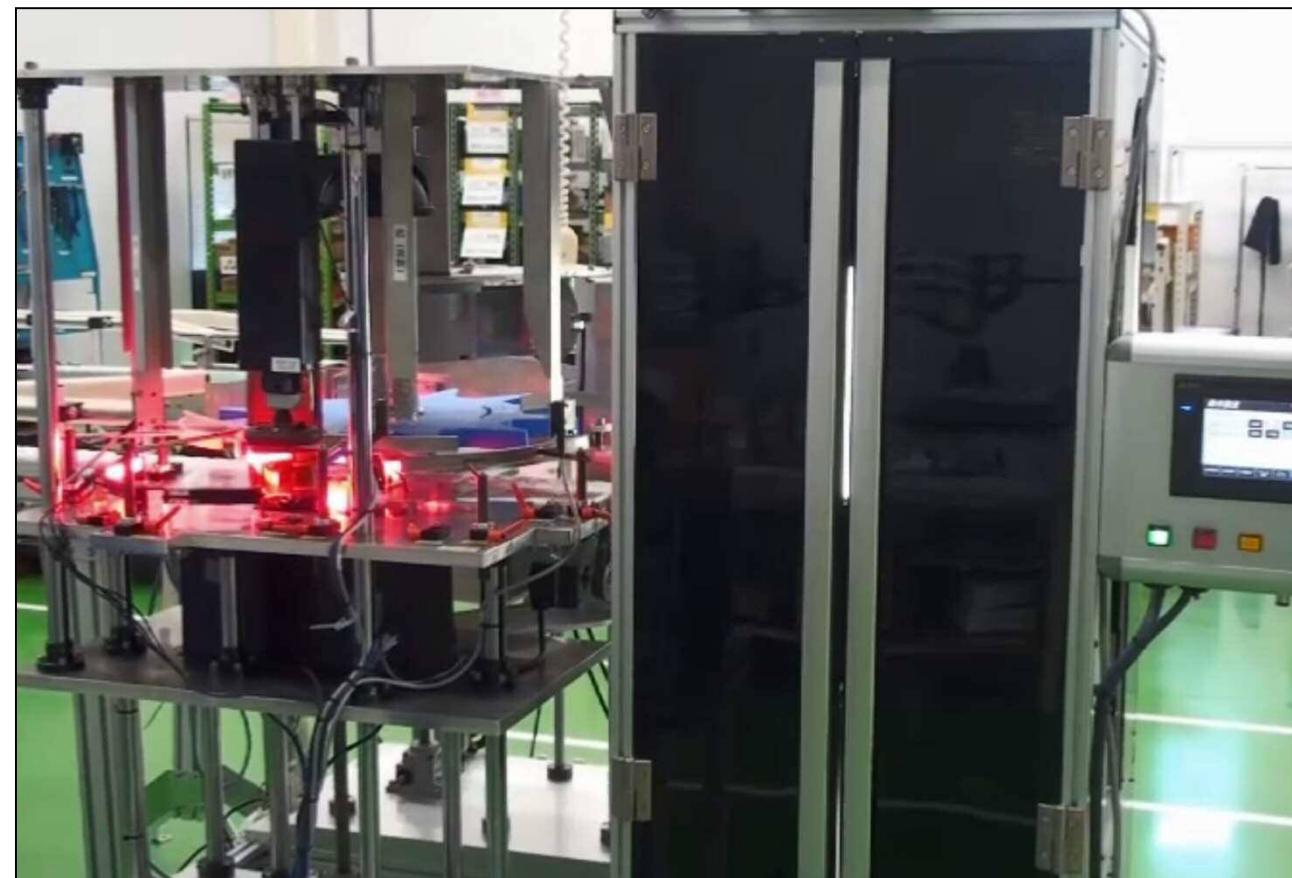


# 異物画像検査機

|       |              |
|-------|--------------|
| 標準    | 胴検査          |
|       | 底検査          |
| オプション | ① 高精度胴検査     |
|       | ② 入味量検査      |
|       | ③ 液面浮遊検査     |
|       | ④ 底毛髪検査      |
|       | ⑤ NG排出・ストッカー |

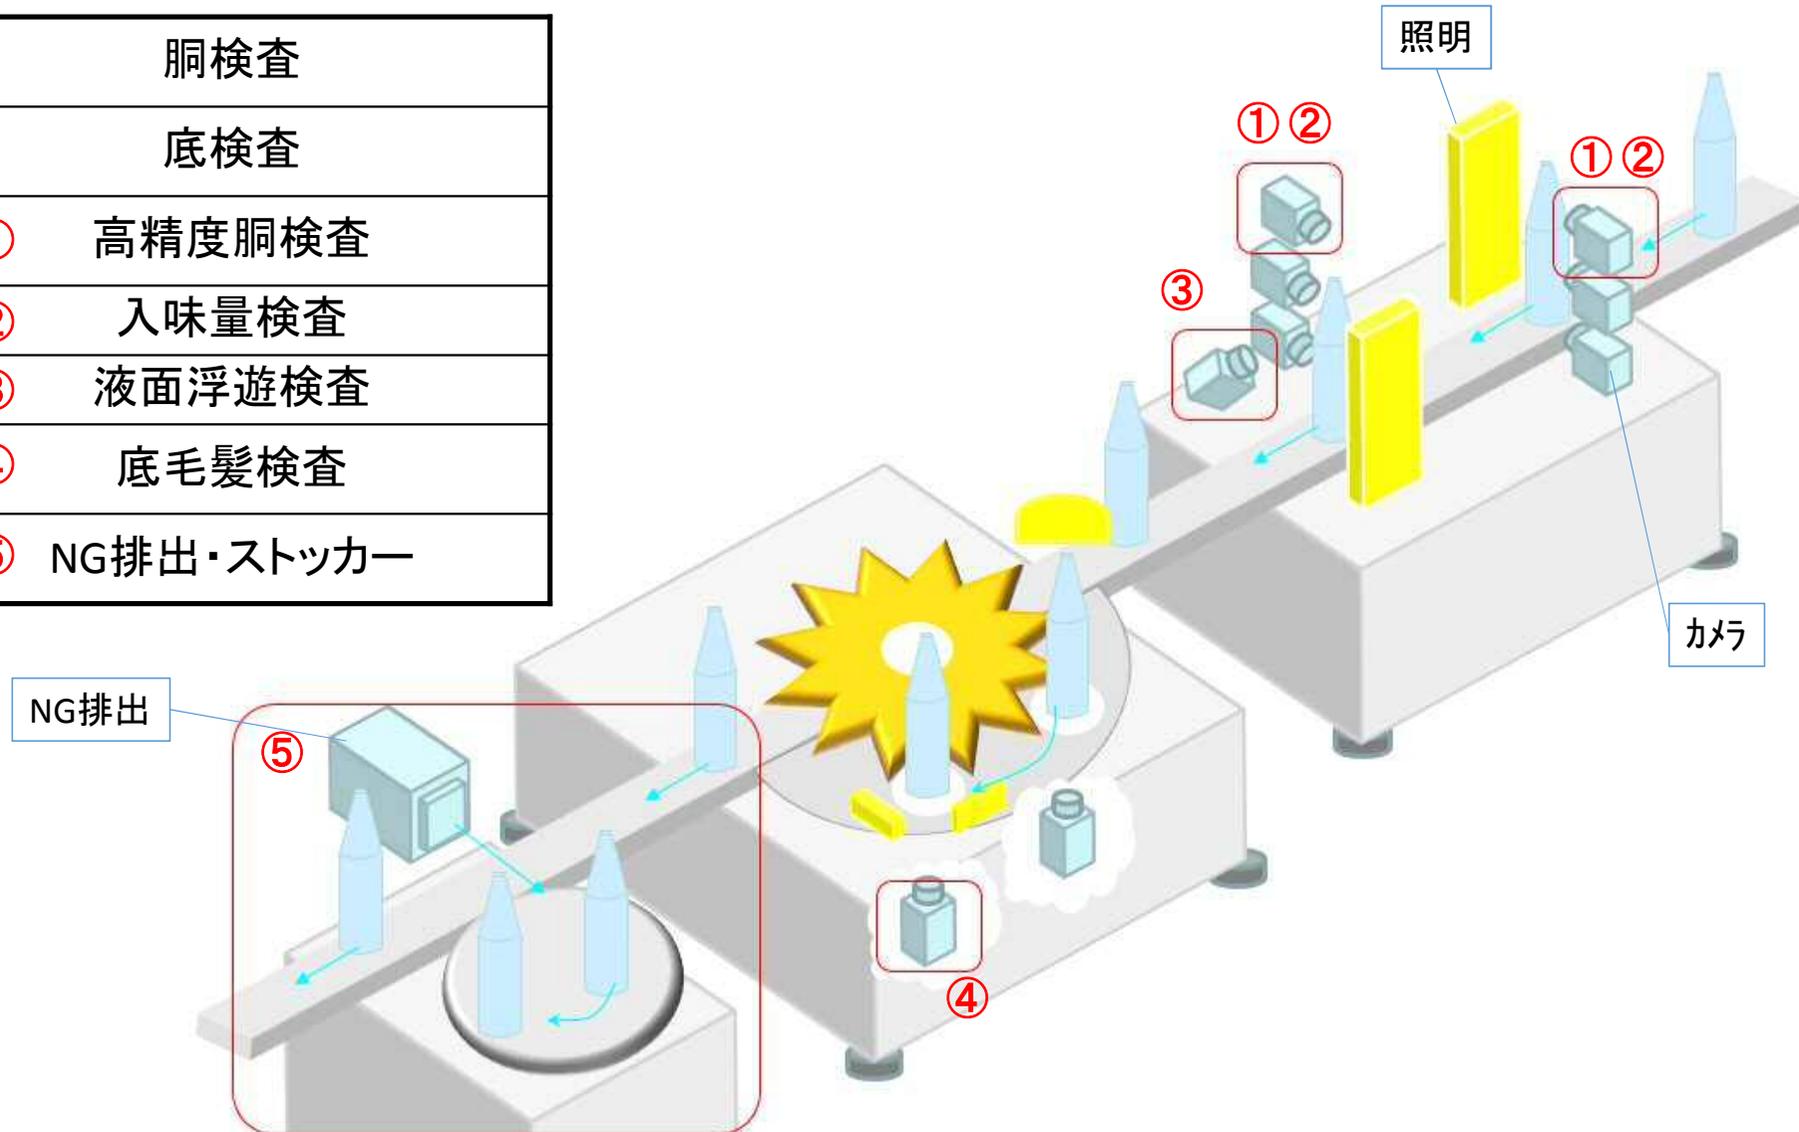

# 異物画像検査機

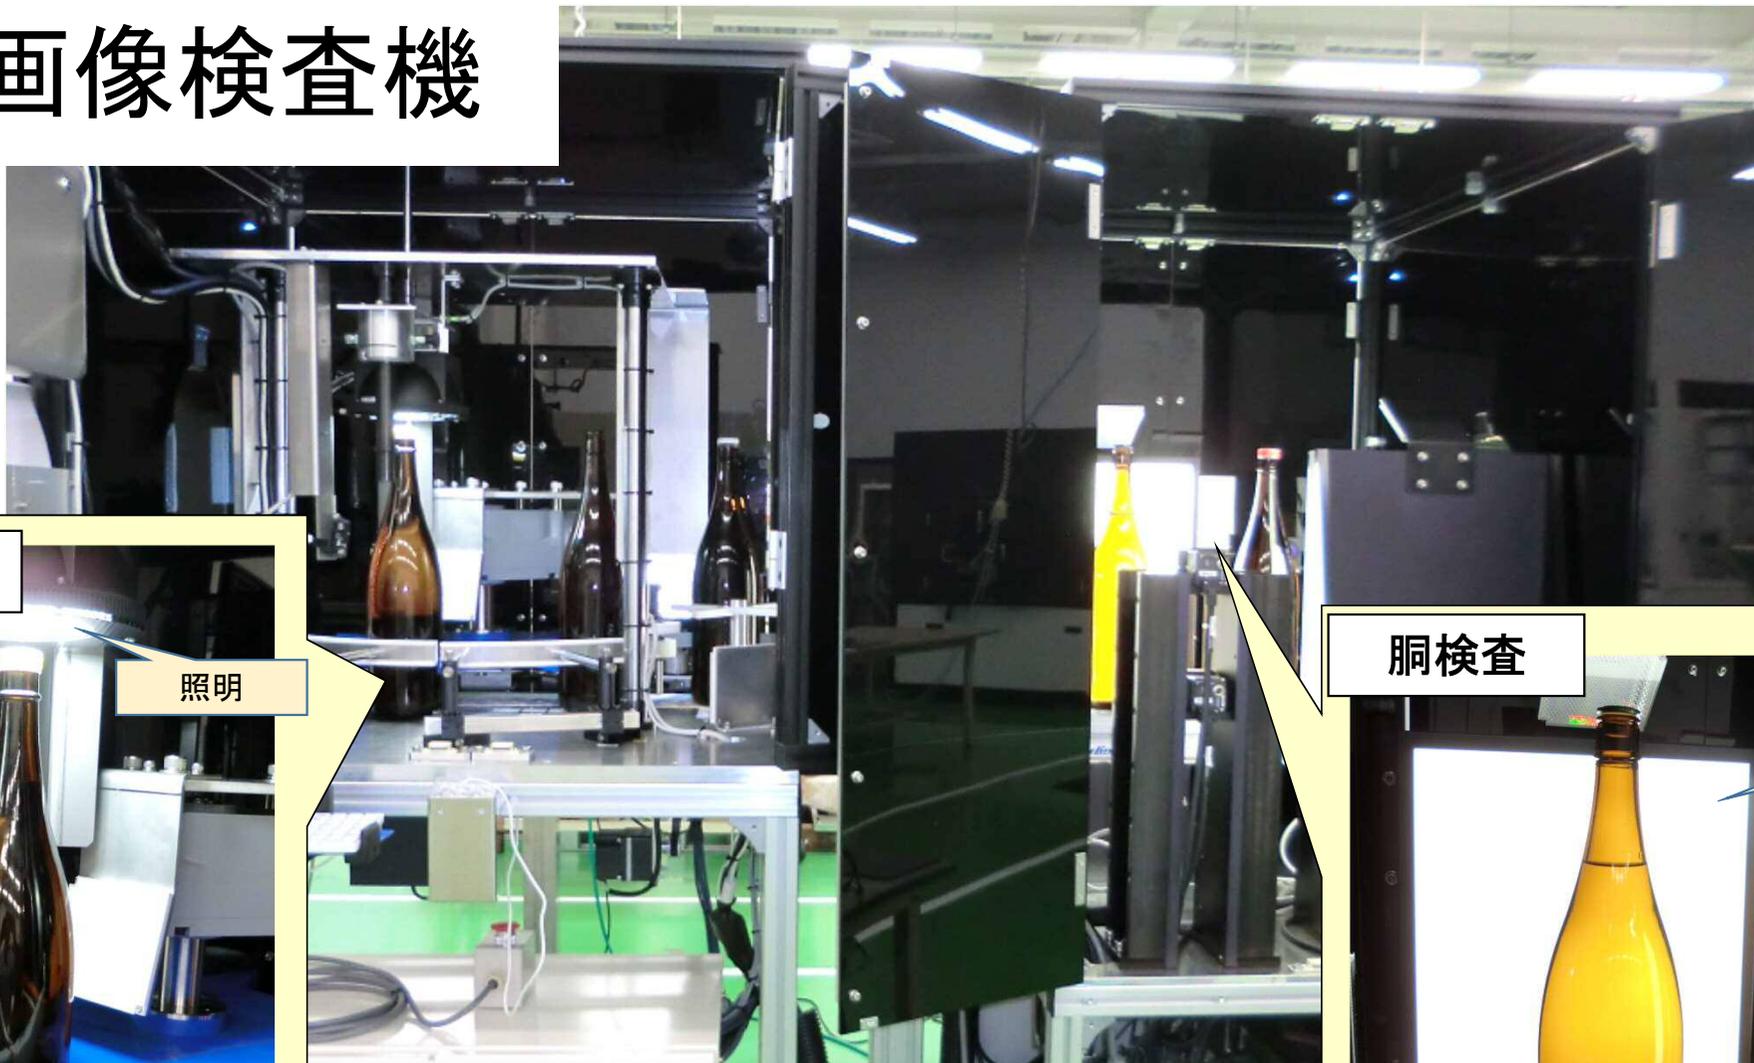

底検査

照明

カメラ

胴検査

照明

カメラ

# 仕様

## 【検査対象】

- ・ガラス製の一升瓶、小瓶(720ml～900ml)。ただし光の透過しない不透明瓶を除く。
- ・液中に浮遊、或いは沈殿している不透明異物の検出。

## 【検出能力】

|     |                  | 一升瓶              | 小瓶<br>(720ml～900ml) | フロスト小瓶 |
|-----|------------------|------------------|---------------------|--------|
| 胴検査 | 標準               | 0.2mm            | 0.2mm               | 0.5mm  |
|     | オプション<br>(カメラ追加) | 0.1mm            | 0.1mm               |        |
| 底検査 | 標準<br>(外周異物)     | 0.6mm            | 0.6mm               | 0.6mm  |
|     | オプション<br>(毛髪)    | 長さ5mm<br>太さ100um | 長さ5mm<br>太さ100um    | ×      |

## 【特徴・設備能力】

|      |            |       |
|------|------------|-------|
| 処理能力 | 標準         | 60本/分 |
|      | オプション(廉価版) | 12本/分 |